



山东仁科

RS-SZJCZ-T*-7 太阳能浮漂水质监测站—污水处理基础款用户手册 V1.0

RS-SZJCZ-T*-7

太阳能浮漂水质监测站

污水处理基础款

用户手册

文档版本：V1.0





目录

| | |
|----------------------|----|
| 1.1 功能特点 | 3 |
| 1.2 技术参数 | 3 |
| 1.2.1 结构图 | 4 |
| 1.3 产品选型 | 4 |
| 2. 设备安装 | 4 |
| 2.1 设备结构 | 4 |
| 2.2 安装过程 | 5 |
| 3. 维护和保养 | 5 |
| 3.1 维护方法 | 5 |
| 3.2 注意事项 | 5 |
| 4. 变送器参数 | 6 |
| 4.1 一体式 PH 变送器 | 6 |
| 4.1.1 产品介绍 | 6 |
| 4.1.2 功能特点 | 6 |
| 4.1.3 设备技术参数 | 6 |
| 4.2 一体式 EC 变送器 | 7 |
| 4.2.1 产品介绍 | 7 |
| 4.2.2 功能特点 | 7 |
| 4.2.3 设备技术参数 | 7 |
| 4.3 溶解氧变送器 | 8 |
| 4.3.1 产品介绍 | 8 |
| 4.3.2 功能特点 | 8 |
| 4.3.3 设备技术参数 | 8 |
| 4.4 余氯变送器 | 9 |
| 4.4.1 产品介绍 | 9 |
| 4.4.2 功能特点 | 9 |
| 4.4.3 设备技术参数 | 9 |
| 5. 联系方式 | 10 |
| 6. 文档历史 | 10 |
| 附录：平台上传节点说明 | 11 |



1. 系统概述

RS-SZJCZ-T*-7 是一款基础型污水处理水质监测站；主要应用于污水处理末端，监控污水处理厂的出水水质，考核污水处理厂工艺运行成果，其本身搭配太阳能板及锂电池，并配有数据采集传输模块，可独立完成水质监测任务。

系统将数据实时上传至我公司提供的免费云平台或者客户自己的服务器。可通过网页端、本地端、微信公众号、手机 APP 进行查看数据，且可以短信、语音、邮件、微信公众号推送超限报警，设备离线等重要通知，而且可以储存历史数据、报警数据，自由分配查看数据权限等功能，实现对现场水质的智能监测。


1.1 功能特点

- 可监测水温、酸碱度、电导率、溶解氧、余氯五项参数。
- 自带 4G 上传，通过 4G 可将数据实时上传至我公司提供的免费云平台或者客户自己的服务器，可通过网页端，本地端、微信公众号、手机 APP 进行查看数据。
- 加强型不锈钢滤网，对探头起到绝对保护。
- 自带饵环，便于安装固定。
- 整体适应性强，可用于多种场合。

1.2 技术参数

| 名称 | 参数 |
|------|--|
| 输出信号 | 4G |
| 测量要素 | 水温、酸碱度、电导率、溶解氧、余氯 |
| 工作条件 | 0~50℃, <0.6MPa |
| 电源 | 太阳能供电：基础版（30W 太阳能板+12V20Ah 锂电池） 旗舰版（60W 太阳能板+45Ah 锂电池） 锥形款（15W 太阳能板*4+45Ah 锂电池） 经济款（30W 太阳能板+12V20Ah 锂电池） |
| 尺寸 | 基础款、旗舰款：直径 700mm；高度 700mm； 锥形款：1047*1047*632mm 经济款：530*420*700mm |
| 结构组成 | 基础支架、供电系统、监测系统 |
| 浮漂材料 | 耐腐蚀塑料 |
| 滤网材料 | 304 不锈钢 |
| 探头数量 | 4 |
| 续航时间 | 基础款、经济款：连续阴雨天续航 4 天 旗舰款、锥形款：连续阴雨天续航 7 天 |
| 使用寿命 | 变送器 2 年或以上，探头一年 |

1.2.1 结构图

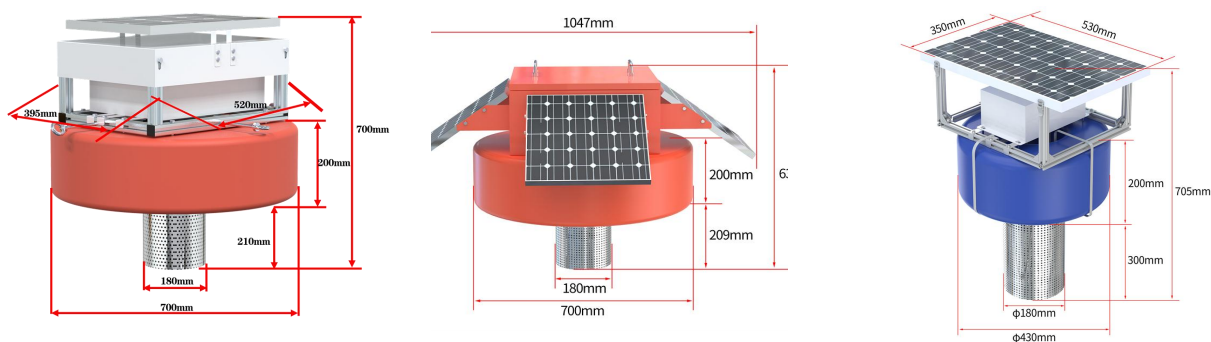

1.3 产品选型

| | | | |
|-----|--------|-----|----------|
| RS- | | | 公司代号 |
| | SZJCZ- | | 水质监测站 |
| | | T1- | 太阳能浮漂基础款 |
| | | T2- | 太阳能浮漂升级款 |
| | | T3- | 太阳能浮漂锥形款 |
| | | T4- | 太阳能浮漂经济款 |
| | | 7 | 污水处理基础款 |

2. 设备安装

2.1 设备结构

设备由基础支架，供电系统和监测系统构成

基础支架：

浮漂+不锈钢滤网+探头安装支架+太阳能安装支架+防水箱+遮雨板

供电系统：

30W 光伏板+20Ah 锂电池


60W 太阳能板+45Ah 锂电池

监测系统：


网络数据采集器+一体式 PH 变送器+一体式 EC 变送器+溶解氧传感器（淡水版）+余氯变送器（0-20mg/L）

2.2 浮漂固定


(1) 锚链式浮漂固定

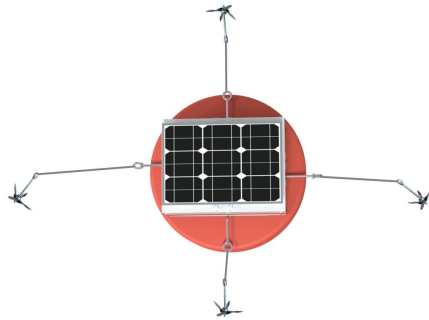

(2) 岸边站浮漂固定

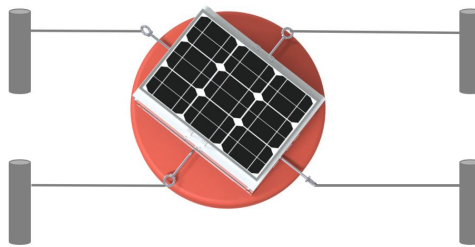

(3) 沉底配重式浮漂固定

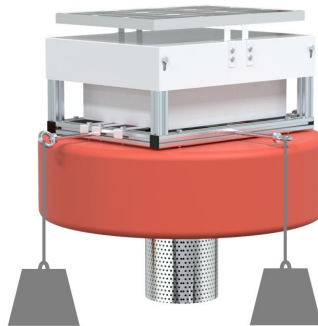

2.3 电气连接

全部为防水对插线，按线标对插即可使用，无复杂接线过程

3. 维护和保养

3.1 维护方法

- 建议冬季水面封冻之前将设备取出
- 建议风浪过大时将设备取出
- 避免靠近岸边太近，造成滤网堵塞，
- 依据现场水质杂质情况，适时清理滤网

3.2 注意事项

安装测量：避免在水流湍急处安装测量，减少水流气泡对测量的影响。



4. 变送器参数

4.1 一体式PH变送器

4.1.1 产品介绍

■ 本产品是一款测量溶液 PH 值（氢离子浓度指数、酸碱度）的设备,具有自动温度补偿功能,自动温补和手动温补可随意切换。本产品采用一体式设计,结构更加轻简,使用更加便捷。防水等级 IP68。本产品适用于无腐蚀性弱酸弱碱环境下的工业污水、生活污水、农业、水产养殖行业等场景。

4.1.2 功能特点

- PH 测量范围 0~14PH, 分辨率 0.01PH。
- 温度测量范围 0~60℃, 分辨率 0.1℃。
- 一体式设计, 结构轻简, 使用便捷。
- 参比采用双盐桥设计, 抗污染能力更强。
- 防水等级 IP68。
- 带有自动温度补偿功能, 手动补偿与自动补偿可随意切换。
- RS485 通讯接口: ModBus-RTU 通讯协议可方便联入计算机进行监测和通讯。
- ModBus 通信地址可设置, 波特率可修改。
- 设备采用宽电压供电直流 7~30V 均可。

4.1.3 设备技术参数

| | |
|---------|--|
| 供电 | DC 7~30V |
| 功耗 | 0.3W |
| 通信接口 | RS485; 标准的 ModBus-RTU 协议; 通信波特率: 默认 4800 (1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200 可设) |
| PH 测量范围 | 0~14.00PH; 分辨率: 0.01PH |
| PH 测量误差 | ±0.15PH |
| 重复性误差 | ±0.02PH |
| 温度测量范围 | 0~60℃; 分辨率: 0.1℃ (手动温度补偿时为设置温度, 默认 25℃) |
| 温度测量误差 | ±0.5℃ |
| 变送器元件耐温 | 0-60℃ |
| 防水等级 | IP68 |
| 耐压 | 0.6MPa |
| 线长 | 默认 1.2m (其余长度可定制) |
| 电极使用周期 | 1 年 |



4.2 一体式EC变送器

4.2.1 产品介绍

本产品是一款测量溶液电导率值的设备,具有自动温度补偿功能,可将当前温度电导率补偿到指定温度。本产品采用一体式设计,结构更加轻简,使用更加便捷。防水等级 IP68。可广泛应用于断面水质、养殖、污水处理、环保、制药、食品和自来水等水溶液电导率值的连续监测。

4.2.2 功能特点

- 电导率测量最大范围 1~20000 μ S/cm; 温度测量范围-20~+60 $^{\circ}$ C, 分辨率 0.1 $^{\circ}$ C。
- 一体式设计, 结构轻简, 使用便捷。
- 防水等级 IP68。
- 带有盐度与 TDS 换算功能
- RS485 通讯接口: ModBus-RTU 通讯协议可方便联入计算机进行监测和通讯。
- ModBus 通信地址可设置, 波特率可修改。
- 设备采用宽电压供电, 直流 10~30V 均可。

4.2.3 设备技术参数

| | |
|----------|---|
| 供电 | DC 10~30V |
| 功耗 | 0.4W |
| 通信接口 | RS485; 标准的 ModBus-RTU 协议; 通信波特率: 默认 4800 (1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200 可设) |
| 电导率测量范围 | K=1: 1~2000 μ S/cm; 分辨率: 0.1 μ S/cm K=10: 10~20000 μ S/cm; 分辨率: 1 μ S/cm |
| 电导率测量误差 | \pm 1%FS |
| 温度测量范围 | -20~+60 $^{\circ}$ C; 分辨率: 0.1 $^{\circ}$ C |
| 温度测量误差 | \pm 0.5 $^{\circ}$ C |
| 温度补偿范围 | -20~+60 $^{\circ}$ C (默认补偿温度 25 $^{\circ}$ C) |
| 温度补偿系数 | 默认 0.02 |
| 盐度测量范围 | K=1: 0~1000ppm; K=10: 0~11476ppm |
| TDS 测量范围 | K=1: 0~1100ppm; K=10: 0~13400ppm |
| 变送器元件耐温 | -20~+60 $^{\circ}$ C |
| 防水等级 | IP68 |
| 耐压 | 0.6MPa |
| 线长 | 默认 1.2m (其余长度可定制) |



4.3 溶解氧变送器

4.3.1 产品介绍

本产品是一款测量溶液溶解氧浓度的设备，采用荧光法测量原理，不消耗氧，无需电解液。内置温度变送器，具有自动温度补偿功能。校准功能提供了更加简单便捷的校准方式。采用具有进口品质的荧光膜片。可广泛应用于水处理、水产养殖、环境监测等行业。

4.3.2 功能特点

- 溶解氧测量范围 0~20mg/L（0~200%饱和度）。
- RS485 通讯接口：ModBus-RTU 通讯协议可方便联入计算机进行监测和通讯。
- ModBus 通信地址可设置，波特率可修改。
- 设备采用宽电压供电，直流 10~30V 均可。
- 采用具有进口品质的荧光膜片。
- 采用荧光法测量原理，不消耗氧，无需电解液。

4.3.3 设备技术参数

| | |
|---------|--|
| 供电 | DC 10~30V |
| 功耗 | 0.2W |
| 通信接口 | RS485；标准的 ModBus-RTU 协议；通信波特率：默认 4800（1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200 可设） |
| 测量原理 | 荧光法 |
| 测量范围 | 0~20mg/L（0~200%饱和度） |
| 测量误差 | ±3%FS；±0.5℃（25℃） |
| 分辨率 | 0.01mg/L；0.1%；0.1℃ |
| 响应时间 | ≤60s |
| 变送器元件耐温 | 0~40℃ |
| 荧光膜寿命 | 正常使用 1 年 |
| 防水等级 | IP68 |
| 耐压 | 0.6MPa |
| 电极线长 | 默认 1.2m（其余长度可定制） |
| 外壳材质 | 耐腐蚀塑料、不锈钢 |



4.4 余氯变送器

4.4.1 产品介绍

本产品是一款测量水体余氯浓度（次氯酸、次氯酸根浓度）的设备。使用三电极体系具有测量精度高、工作寿命长和无需频繁校正等优点。本产品适用于循环水自控加药、游泳池加氯控制以及饮用水处理厂、饮用水分布网、游泳池、医院废水对水溶液中余氯含量的精确测量。

4.4.2 功能特点

- 余氯测量范围为 0-10mg/L，分辨率 0.01mg/L。
- 一体式设计直接输出 485 信号，消除信号干扰。
- 3/4 上下安装螺纹设计，便于安装。
- 防护等级 IP68。
- 采用先进的非膜式恒电压传感器，无须更换膜片与药剂。
- RS485 通讯接口：ModBus-RTU 通讯协议可方便联入计算机进行监测和通讯。
- ModBus 通信地址可设置，波特率可修改。
- 设备采用宽电压供电直流 7~30V 均可。

4.4.3 设备技术参数

| | |
|----------|---|
| 供电 | DC 7~30V |
| 功耗 | 0.19W |
| 通信接口 | RS485；标准的 ModBus-RTU 协议；通信波特率默认为 4800 |
| 余氯浓度测量范围 | 0-10mg/L，分辨率 0.01mg/L 0-2mg/L，分辨率 0.01mg/L |
| 余氯测量误差 | ±5%FS |
| 重复性误差 | ±0.05mg/L |
| 响应时间 | <30s |
| 设备工作条件 | 变送器元件耐温：0-40℃ PH：4-9 流速：30~60L/h |
| 变送器耐压 | 0.6MPa |
| 变送器线长 | 默认 1.2m（其余长度可定制） |
| 变送器使用周期 | 1 年 |
| 防护等级 | IP68 |



5. 联系方式

山东仁科测控技术有限公司

营销中心：山东省济南市高新区舜泰广场 8 号楼东座 10 楼整层

邮编：250101

电话：400-085-5807

传真：（86）0531-67805165

网址：www.rkckth.com

云平台地址：www.0531yun.com



山东仁科测控技术有限公司  官网



欢迎关注微信公众平台，智享便捷服务

6. 文档历史

V1.0 文档建立



山东仁科

附录：平台上传节点说明

| 节点 | 数据说明 | 起始寄存器 | 寄存器个数 | 数据类型 |
|----|-----------------|-------|-------|---|
| 1 | PH+温度 | 0 | 2 | 温度： 模拟量 1 系数 0.1 单位℃ 量程 0~80 PH： 模拟量 2 系数 0.01 量程 0~14 |
| 2 | 电导率 | 0 | 1 | 模拟量 2 系数 1 单位 μ S/cm 量程 10~20000 |
| 3 | ORP | 0 | 1 | 模拟量 2 系数 1 单位 mV 量程 -2000~2000 |
| 4 | 溶解氧 | 2 | 2 | 浮点型 系数 1 单位 mg/L 量程 0~20 |
| 5 | 浊度 | 0 | 1 | 模拟量 2 系数 0.1 单位 NTU 量程 0~4000 |
| 6 | 氨氮 | 0 | 1 | 模拟量 2 系数 0.1 单位 mg/L 量程 0~10 |
| 7 | COD | 0 | 1 | 模拟量 2 系数 0.1 单位 mg/L 量程 0~500 |
| 8 | 余氯 或 其他离子 | 0 | 1 | 模拟量 2 系数 0.001 单位 mg/L 量程 0~20 |